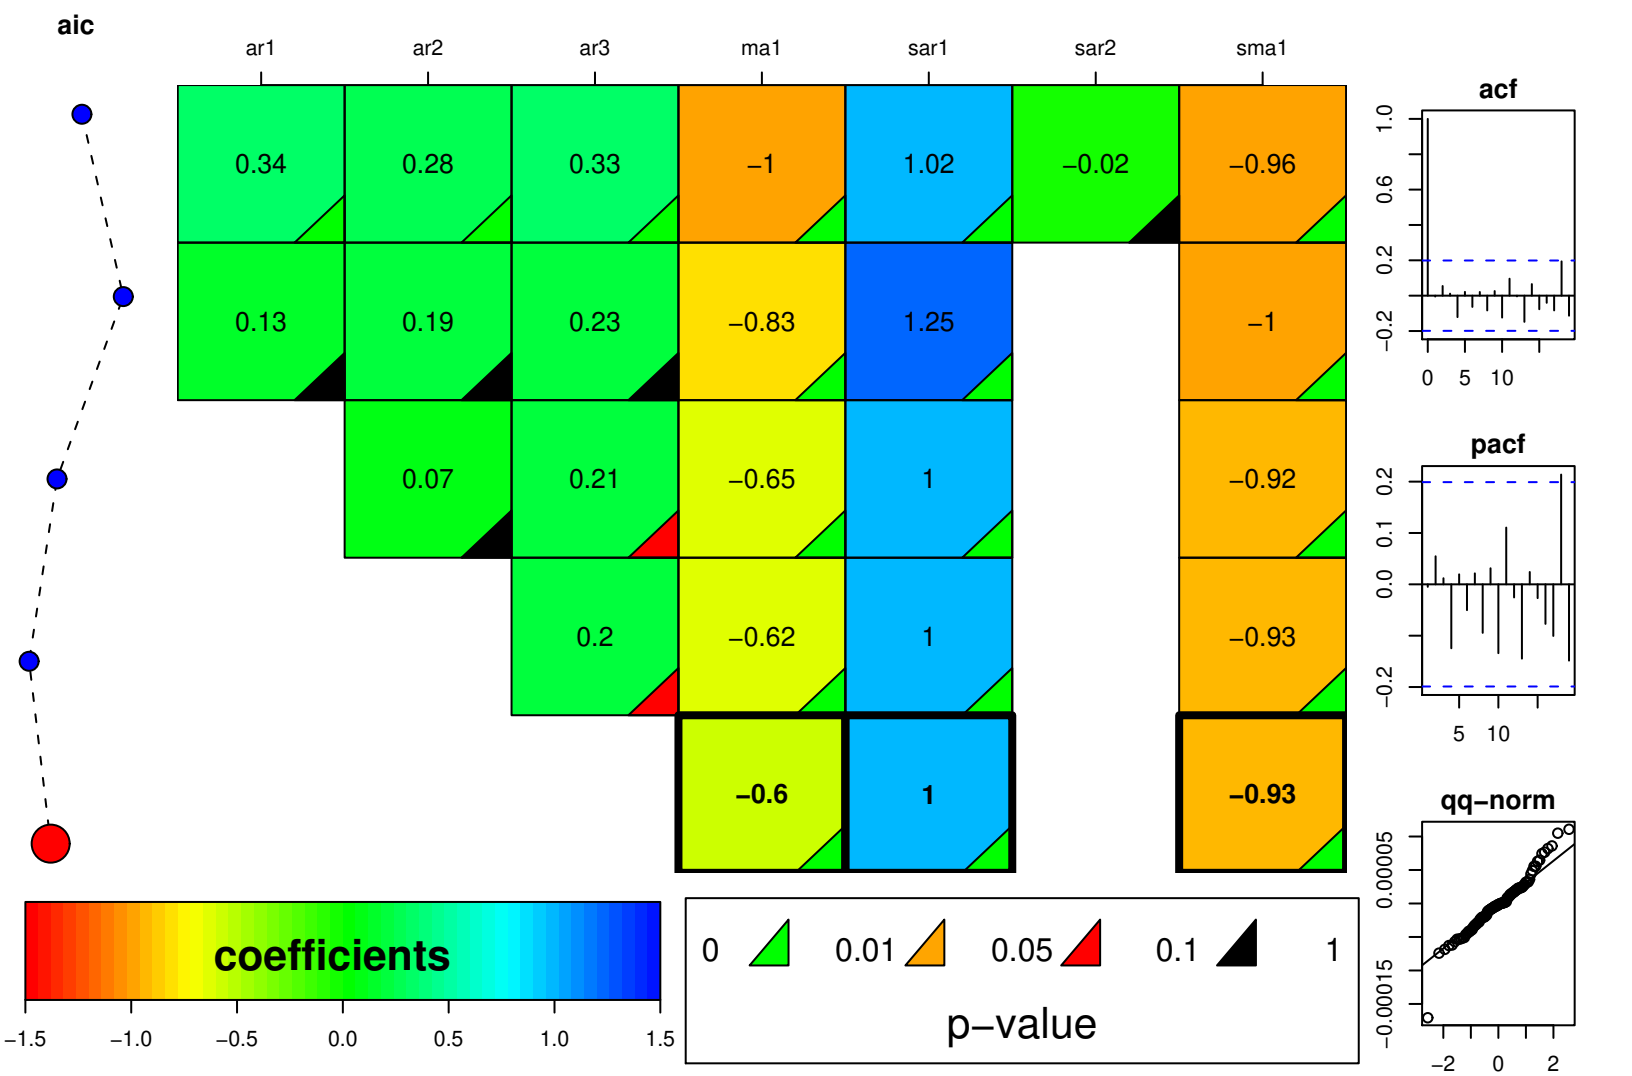
aic
ar1
ar2
ar3
ma1
sar1
sar2
sma1
0.34
0.28
0.33
−1
1.02
−0.02
−0.96
0.13
0.19
0.23
−0.83
1.25
−1
0.07
0.21
−0.65
1
−0.92
0.2
−0.62
1
−0.93
−0.6
1
−0.93
acf
pacf
qq−norm
coefficients
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
0
0.01
0.05
0.1
1
p−value