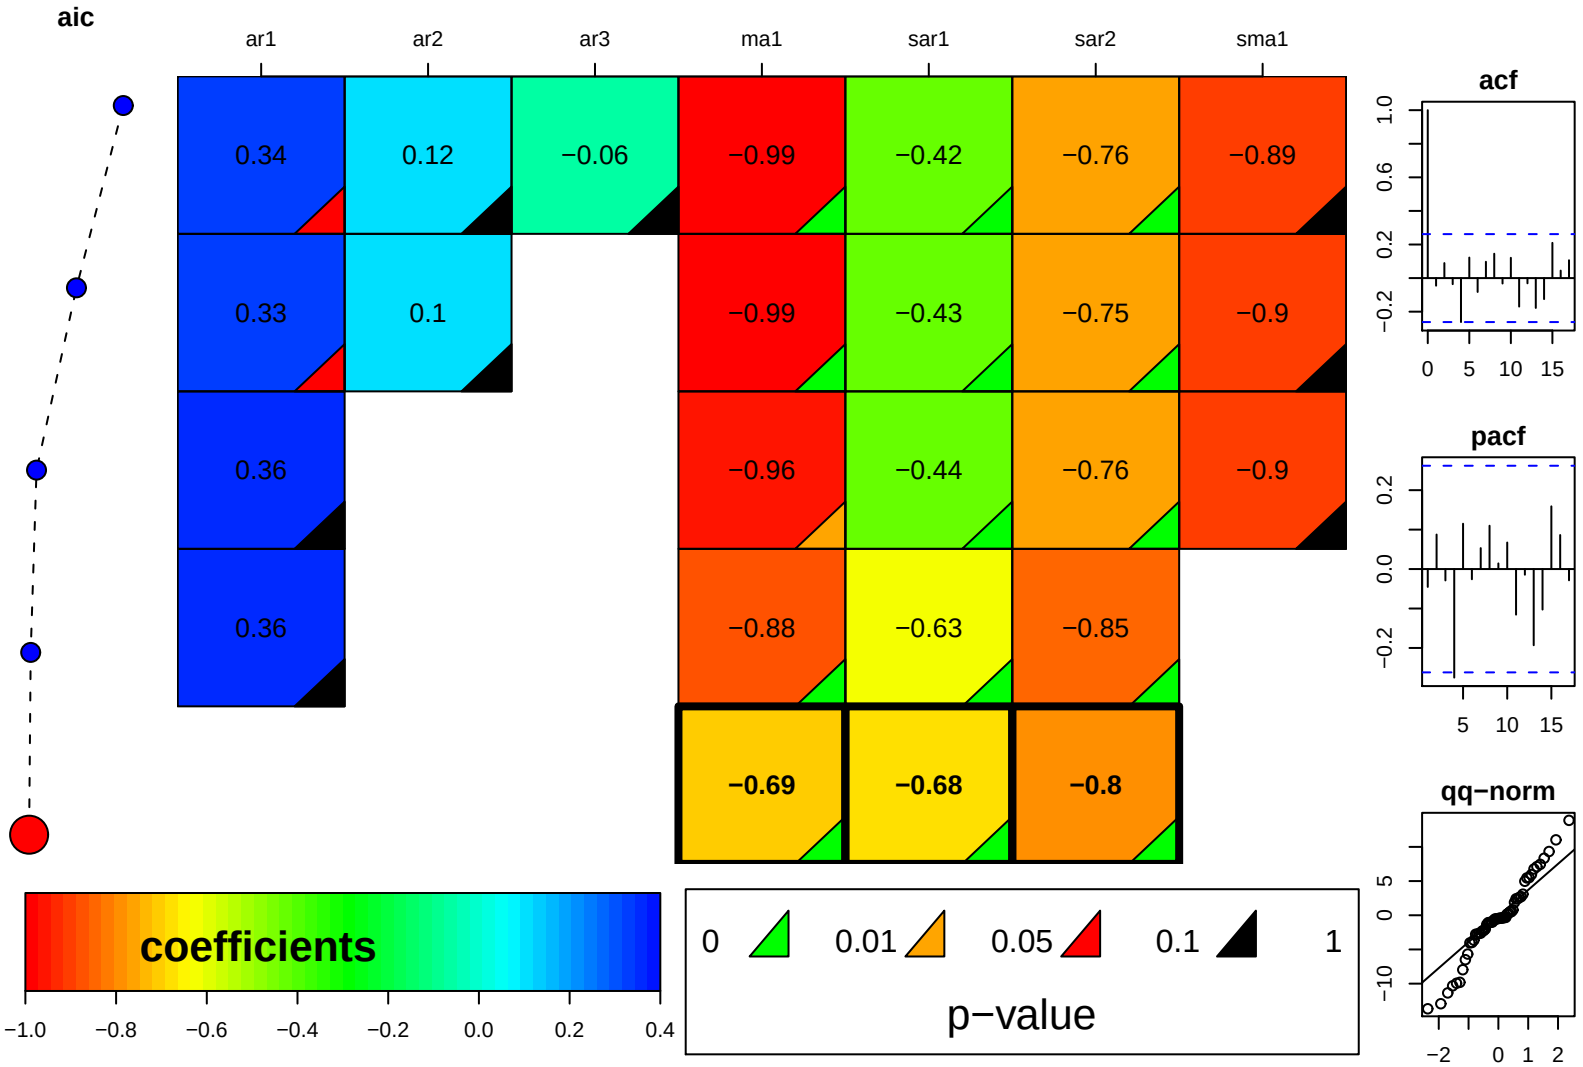
aic
ar1
ar2
ar3
ma1
sar1
sar2
sma1
0.34
0.12
−0.06
−0.99
−0.42
−0.76
−0.89
0.33
0.1
−0.99
−0.43
−0.75
−0.9
0.36
−0.96
−0.44
−0.76
−0.9
0.36
−0.88
−0.63
−0.85
−0.69
−0.68
−0.8
acf
pacf
qq−norm
coefficients
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
0
0.01
0.05
0.1
1
p−value