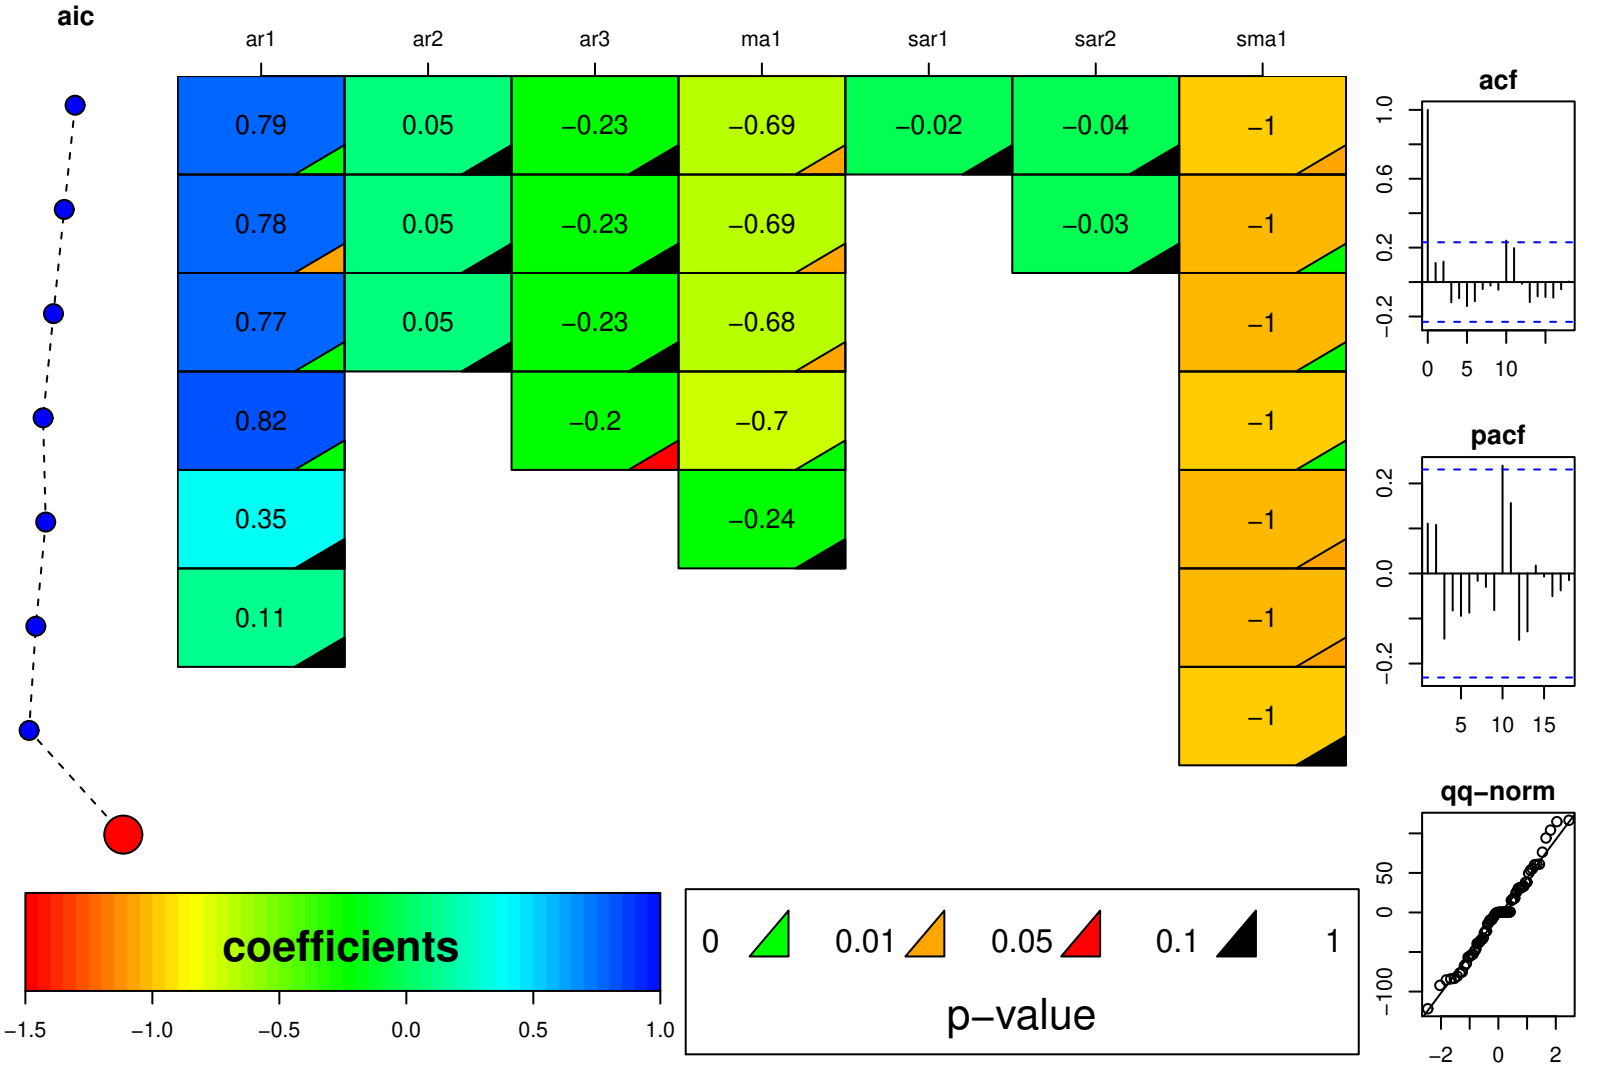
aic
ar1
ar2
ar3
ma1
sar1
sar2
sma1
0.79
0.05
−0.23
−0.69
−0.02
−0.04
−1
0.78
0.05
−0.23
−0.69
−0.03
−1
0.77
0.05
−0.23
−0.68
−1
0.82
−0.2
−0.7
−1
0.35
−0.24
−1
0.11
−1
−1
acf
1.0
0.6
0.2
−0.2
0
5
10
pacf
0.2
0.0
−0.2
5
10
15
qq−norm
50
0
−100
−2
0
2
coefficients
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
0.01
0.05
0.1
1
p−value