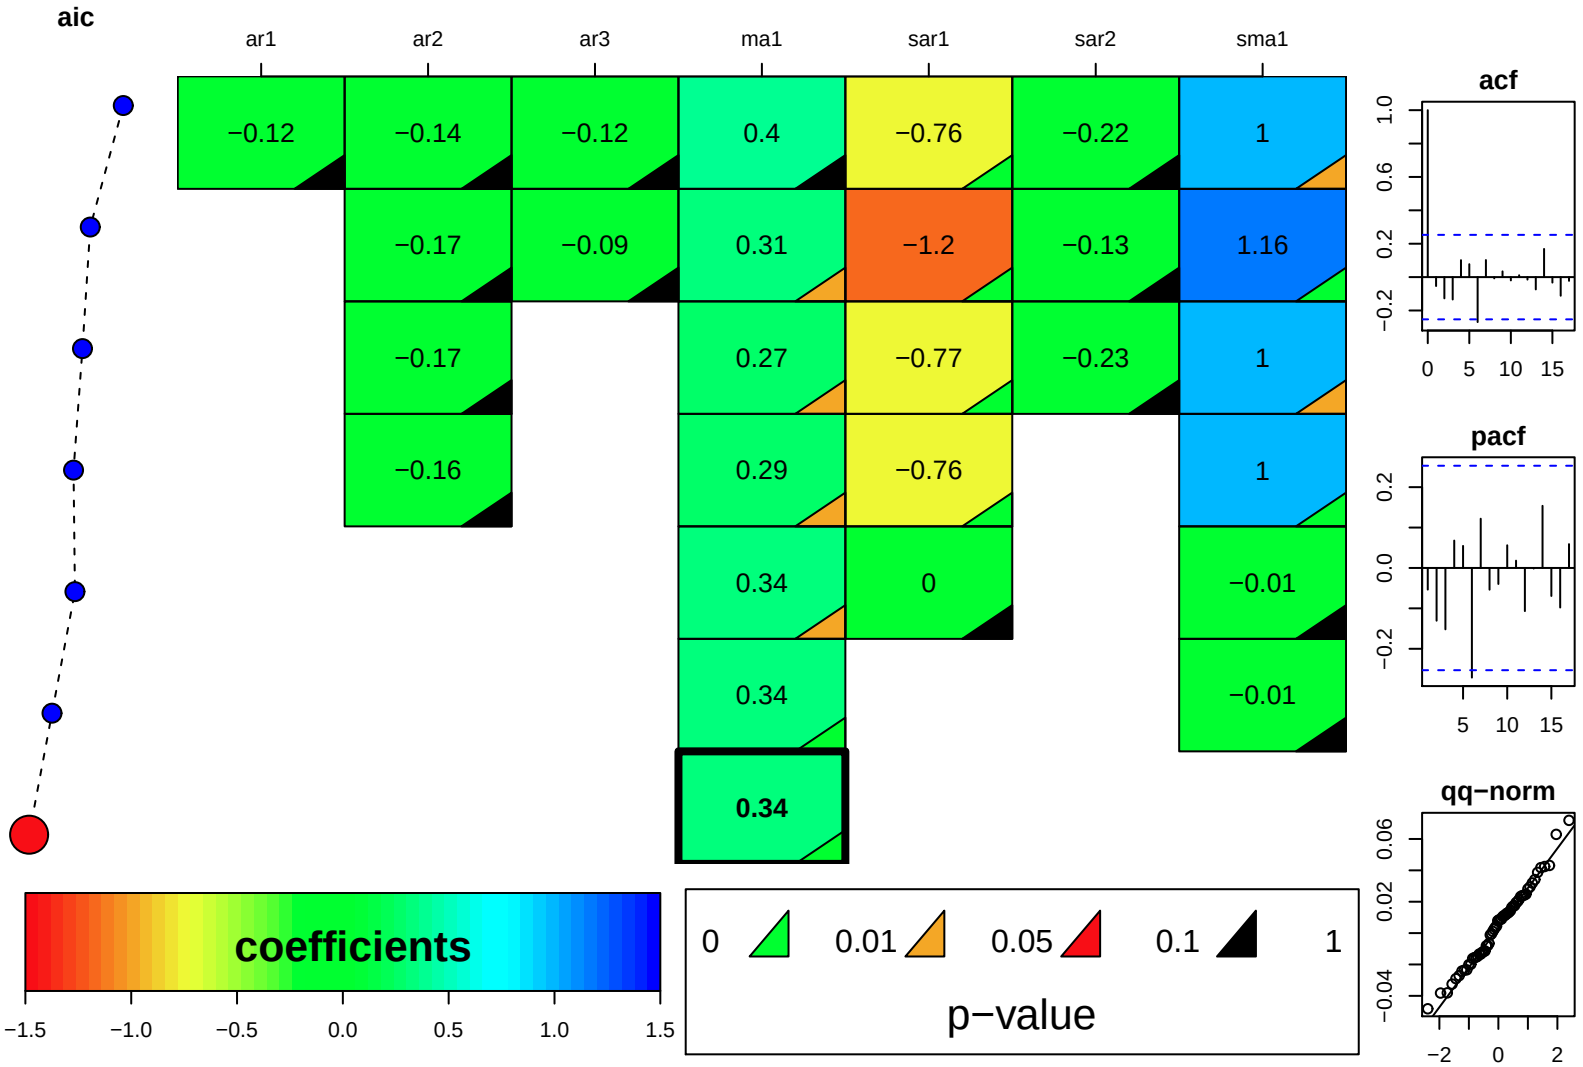
aic
ar1
ar2
ar3
ma1
sar1
sar2
sma1
−0.12
−0.14
−0.12
0.4
−0.76
−0.22
1
−0.17
−0.09
0.31
−1.2
−0.13
1.16
−0.17
0.27
−0.77
−0.23
1
−0.16
0.29
−0.76
1
0.34
0
−0.01
0.34
−0.01
0.34
acf
pacf
qq−norm
coefficients
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
0
0.01
0.05
0.1
1
p−value