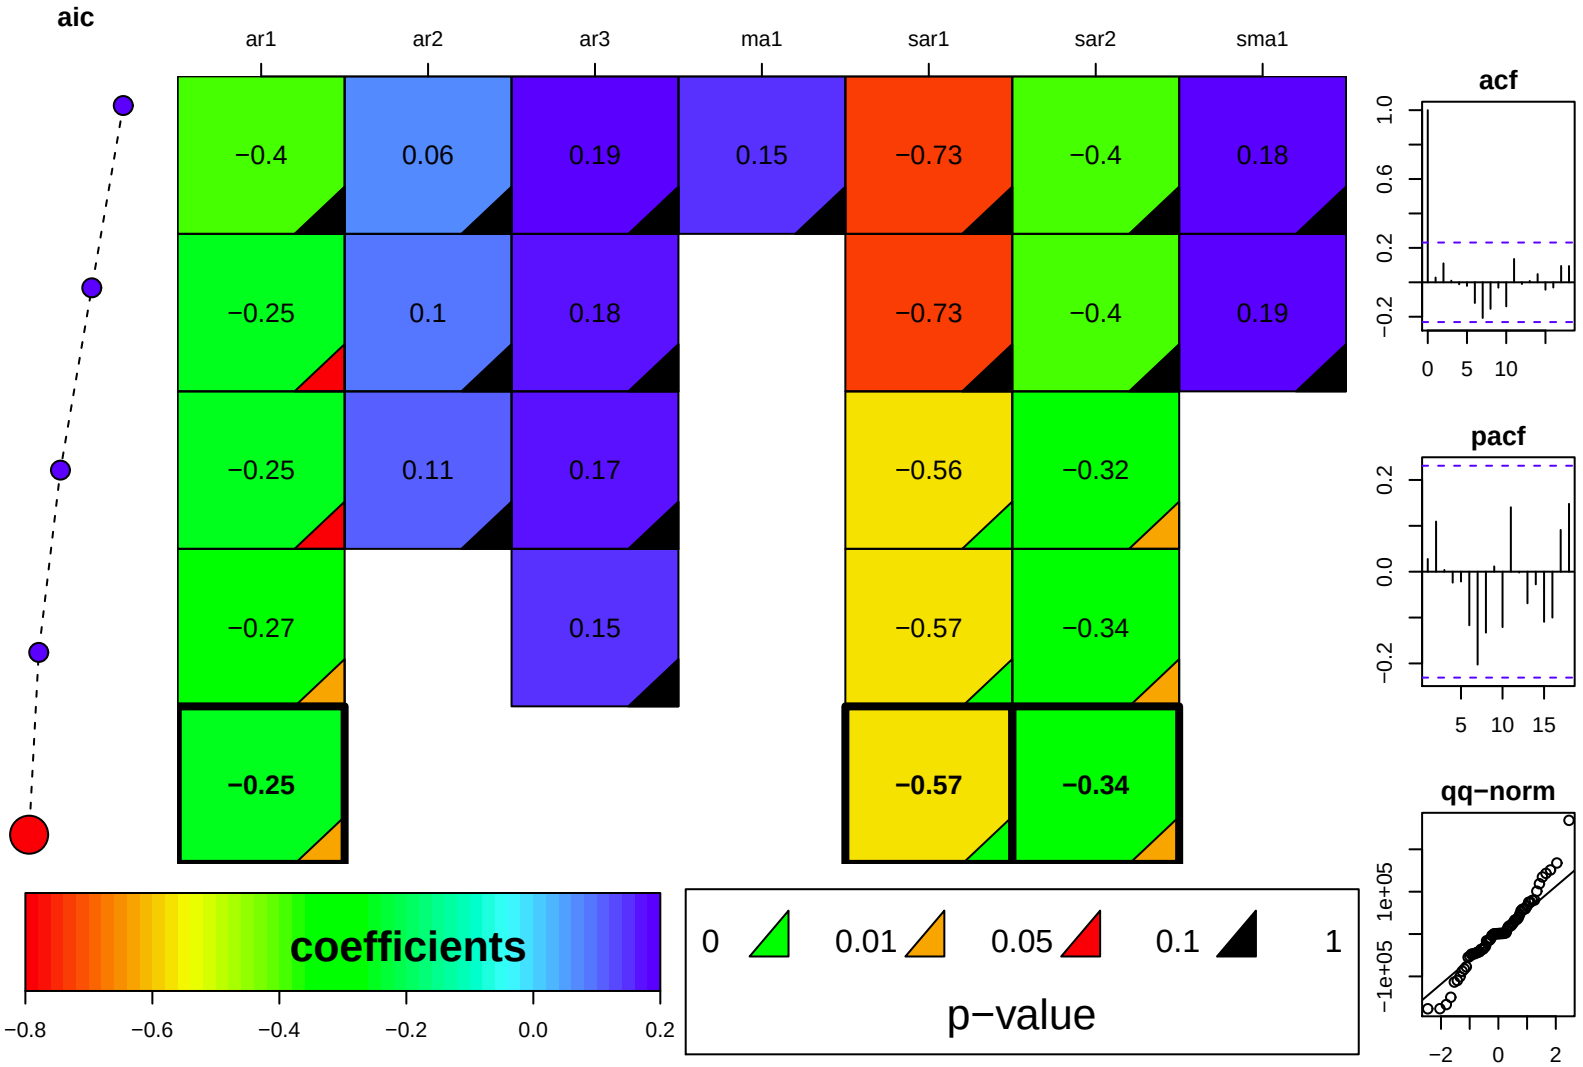
aic
ar1
ar2
ar3
ma1
sar1
sar2
sma1
−0.4
0.06
0.19
0.15
−0.73
−0.4
0.18
−0.25
0.1
0.18
−0.73
−0.4
0.19
−0.25
0.11
0.17
−0.56
−0.32
−0.27
0.15
−0.57
−0.34
−0.25
−0.57
−0.34
acf
pacf
qq−norm
coefficients
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0
0.01
0.05
0.1
1
p−value