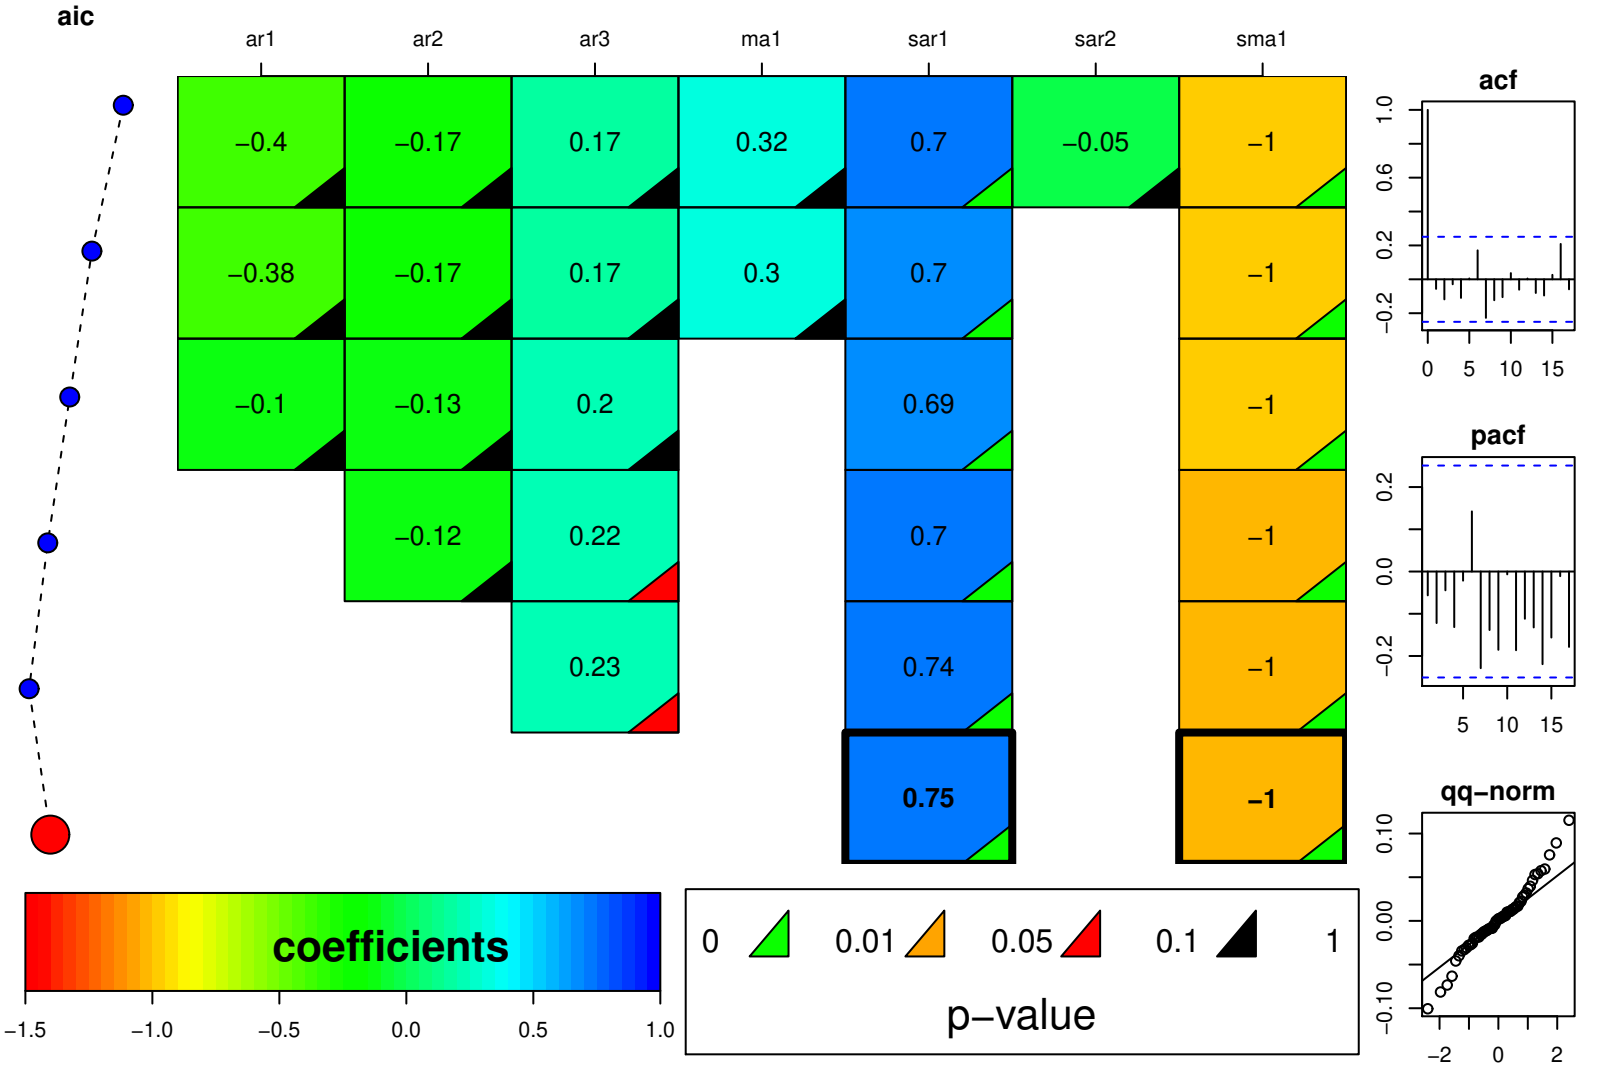
aic
ar1
ar2
ar3
ma1
sar1
sar2
sma1
−0.4
−0.17
0.17
0.32
0.7
−0.05
−1
−0.38
−0.17
0.17
0.3
0.7
−1
−0.1
−0.13
0.2
0.69
−1
−0.12
0.22
0.7
−1
0.23
0.74
−1
0.75
−1
acf
pacf
qq−norm
coefficients
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
0.01
0.05
0.1
1
p−value