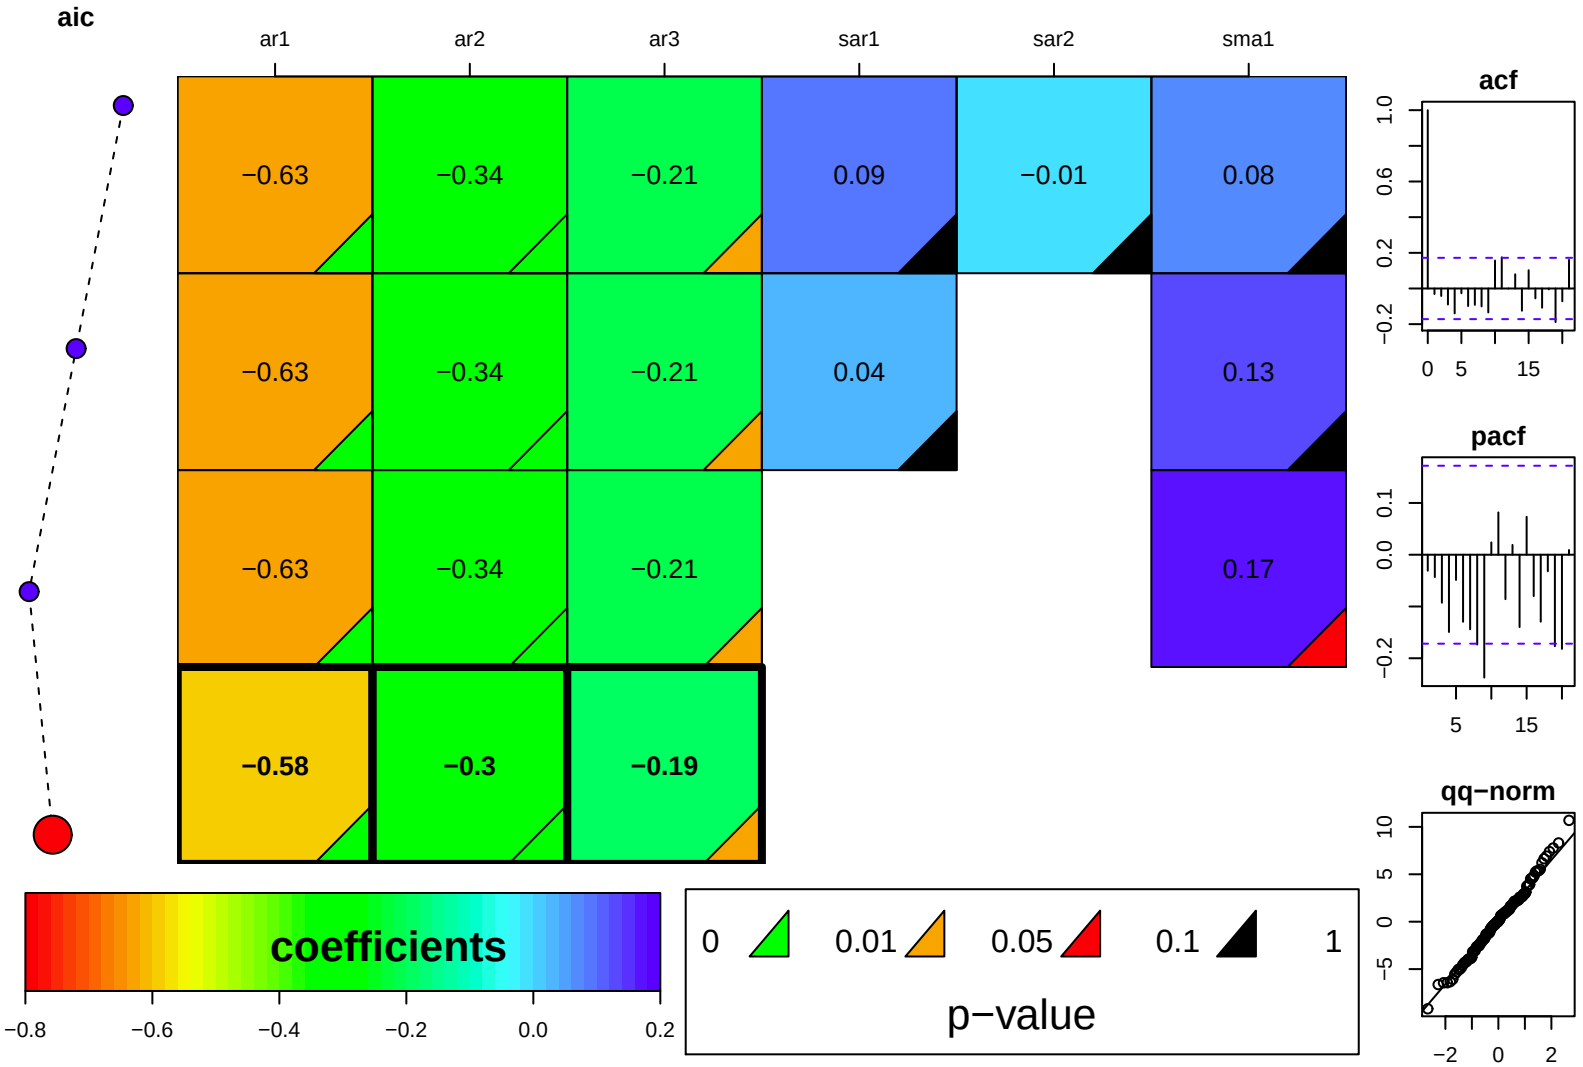
aic
ar1
ar2
ar3
sar1
sar2
sma1
−0.63
−0.34
−0.21
0.09
−0.01
0.08
−0.63
−0.34
−0.21
0.04
0.13
−0.63
−0.34
−0.21
0.17
−0.58
−0.3
−0.19
acf
pacf
qq−norm
coefficients
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0
0.01
0.05
0.1
1
p−value