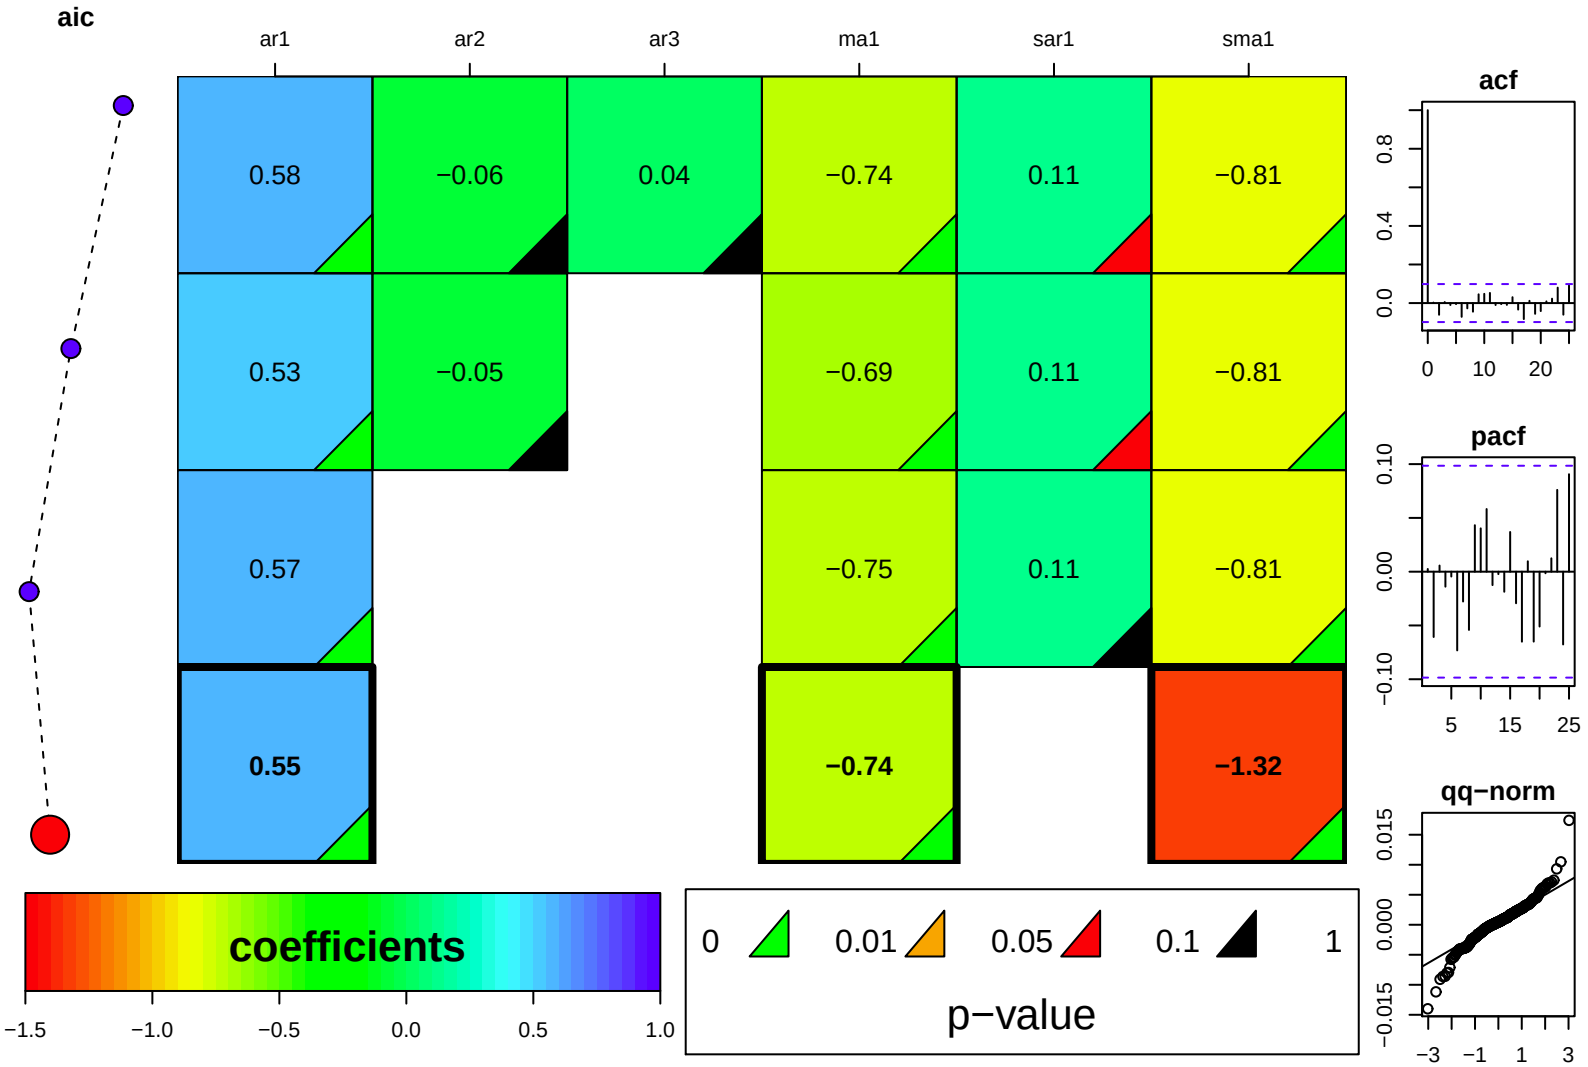
aic
ar1
ar2
ar3
ma1
sar1
sma1
0.58
−0.06
0.04
−0.74
0.11
−0.81
0.53
−0.05
−0.69
0.11
−0.81
0.57
−0.75
0.11
−0.81
0.55
−0.74
−1.32
acf
pacf
qq−norm
coefficients
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
0.01
0.05
0.1
1
p−value