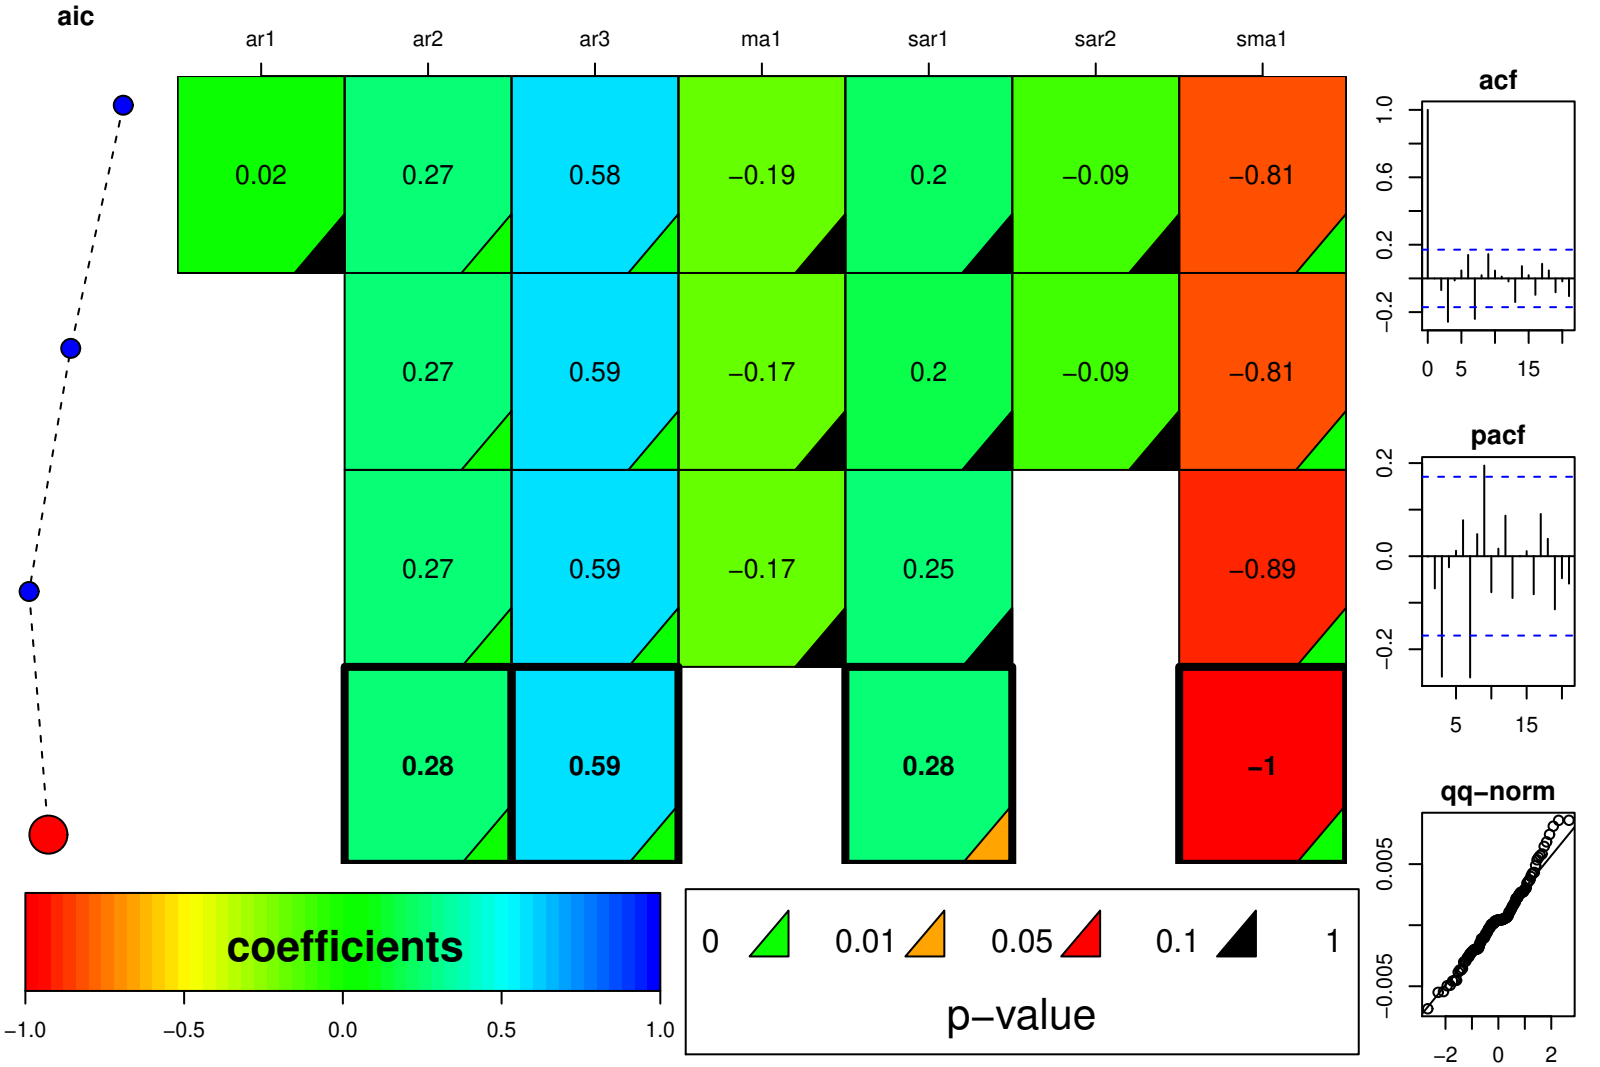
aic
ar1
ar2
ar3
ma1
sar1
sar2
sma1
0.02
0.27
0.58
−0.19
0.2
−0.09
−0.81
0.27
0.59
−0.17
0.2
−0.09
−0.81
0.27
0.59
−0.17
0.25
−0.89
0.28
0.59
0.28
−1
acf
pacf
qq−norm
coefficients
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
0.01
0.05
0.1
1
p−value