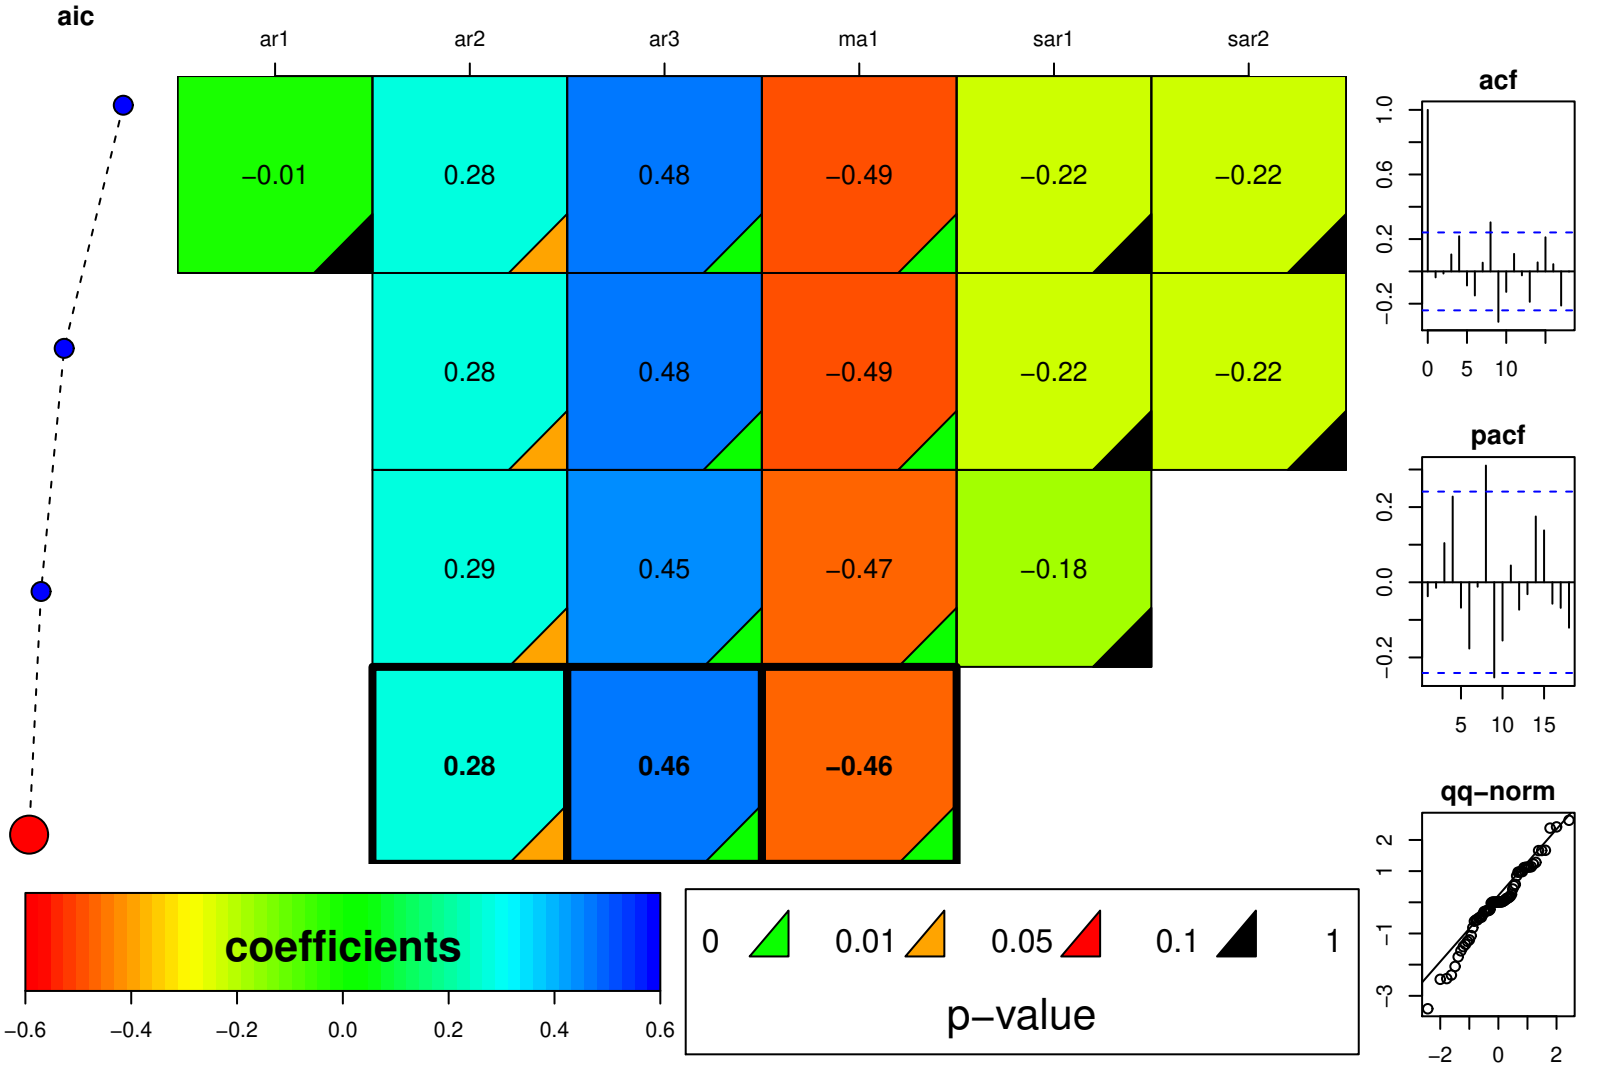
aic
ar1
ar2
ar3
ma1
sar1
sar2
−0.01
0.28
0.48
−0.49
−0.22
−0.22
0.28
0.48
−0.49
−0.22
−0.22
0.29
0.45
−0.47
−0.18
0.28
0.46
−0.46
acf
1.0
0.6
0.2
−0.2
0
5
10
pacf
0.2
0.0
−0.2
5
10
15
qq−norm
2
1
−1
−3
−2
0
2
coefficients
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0
0.01
0.05
0.1
1
p−value