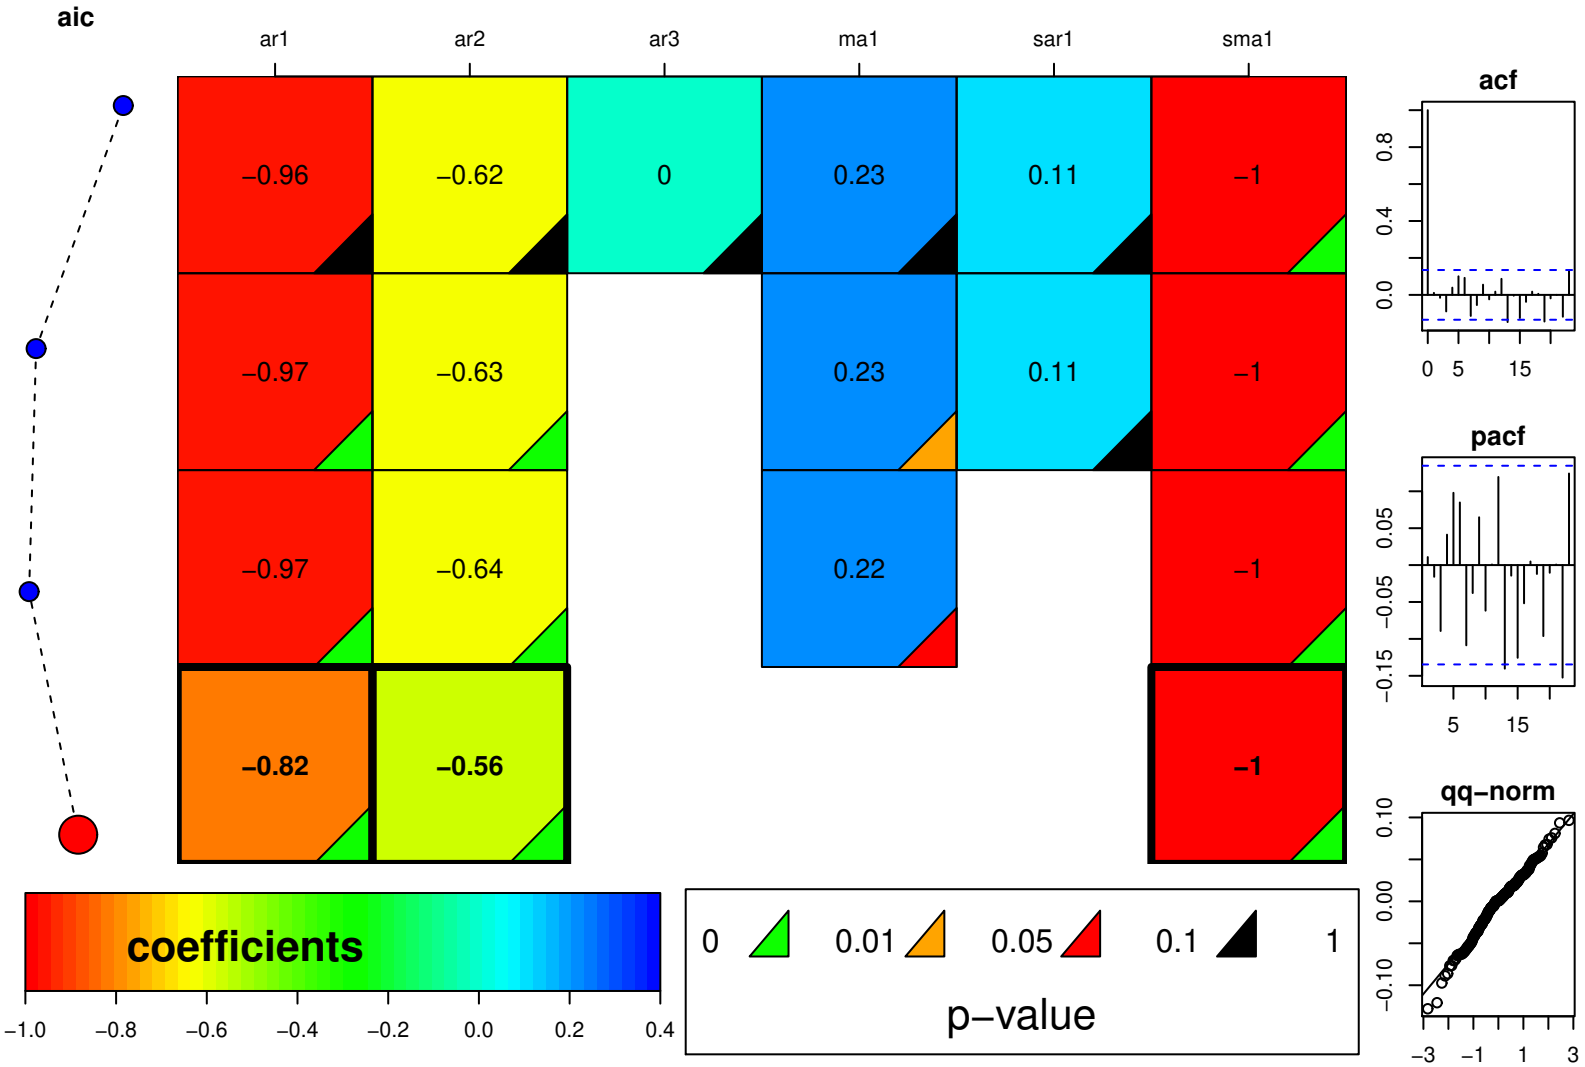
aic
ar1
ar2
ar3
ma1
sar1
sma1
−0.96
−0.62
0
0.23
0.11
−1
−0.97
−0.63
0.23
0.11
−1
−0.97
−0.64
0.22
−1
−0.82
−0.56
−1
acf
pacf
qq−norm
coefficients
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
0
0.01
0.05
0.1
1
p−value